

To: (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl; (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl
From: (10)(2e)
Sent: Fri 5/15/2020 12:21:51 PM
Subject: RE: UV smart- desinfectie van medische aparatuur en mondkapes met UV-licht
Received: Fri 5/15/2020 12:21:52 PM

Ik zet de vraag door naar (10)(2e), V&Z. die beheren de info over hergebruik.
De UV desinfectie is overigens al breed in beeld, en nog niet breed geaccepteerd.

Groet,

(10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Sent: vrijdag 15 mei 2020 14:20
To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: FW: UV smart- desinfectie van medische aparatuur en mondkapes met UV-licht

Hil (10)(2e)

Pak jij dit op? Wat kan (10)(2e) antwoorden?

Groet,

(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)


(10)(2e) (10)(2e)


(10)(2e) (10)(2e)

Dubbel

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

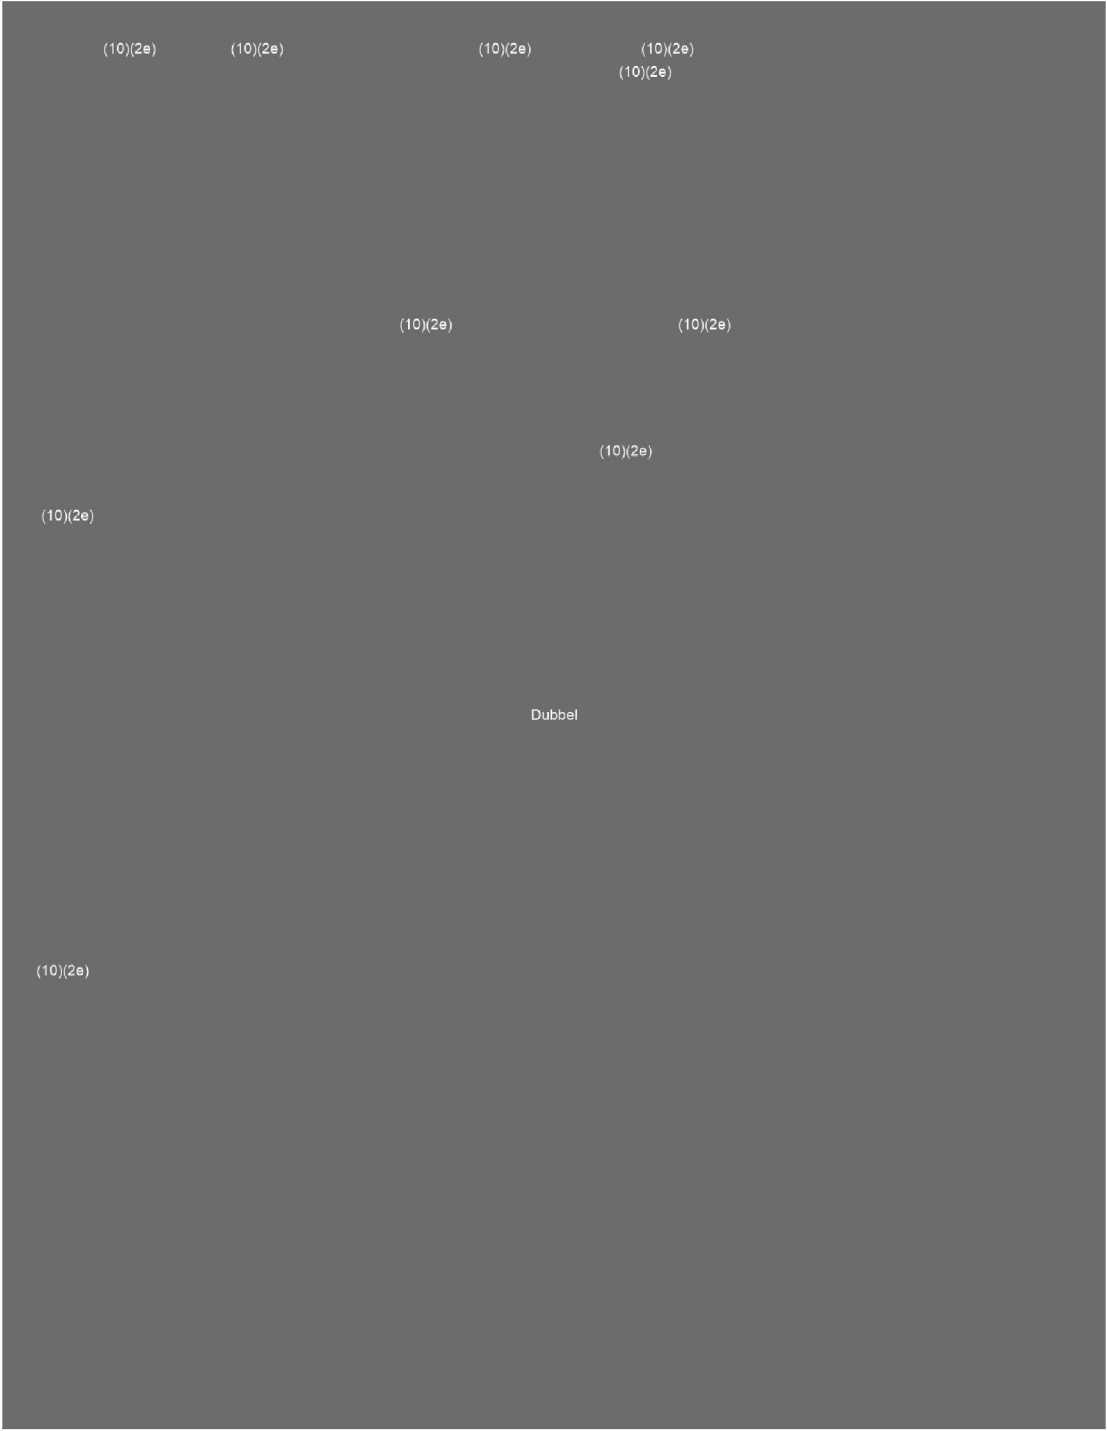



Dubbel