




Materiaal leveringen najaar – huidige wagenpark

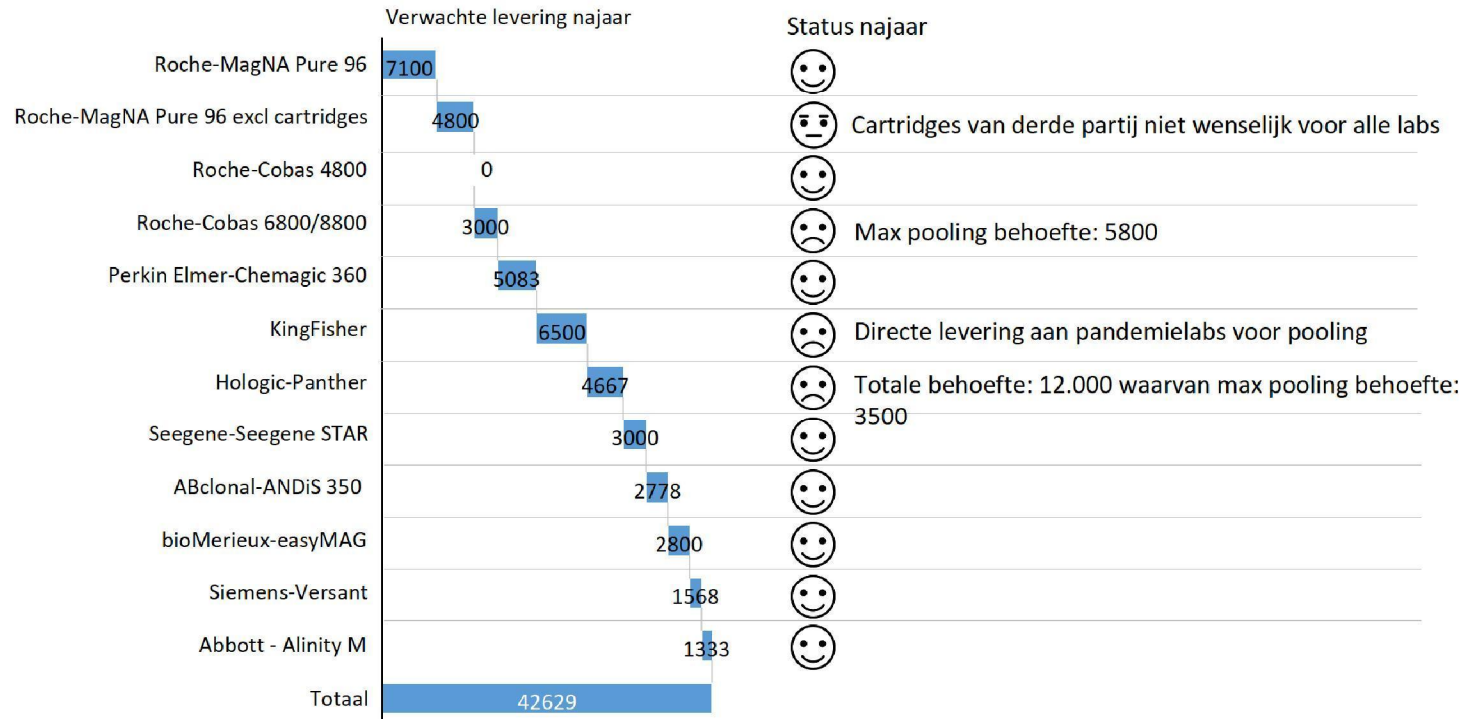


Materiaal leveringen najaar – huidige wagenpark incl. pooling

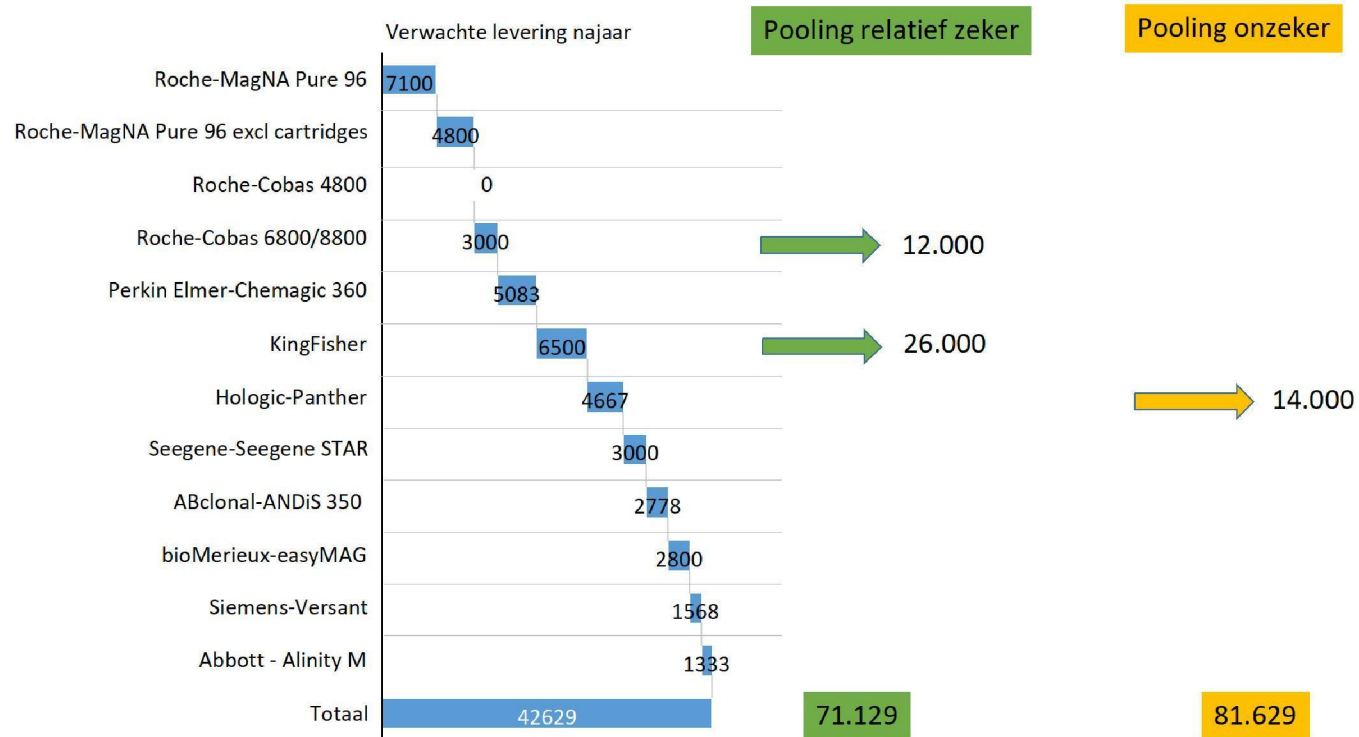

Materiaal leveringen najaar – huidige wagenpark incl. pooling

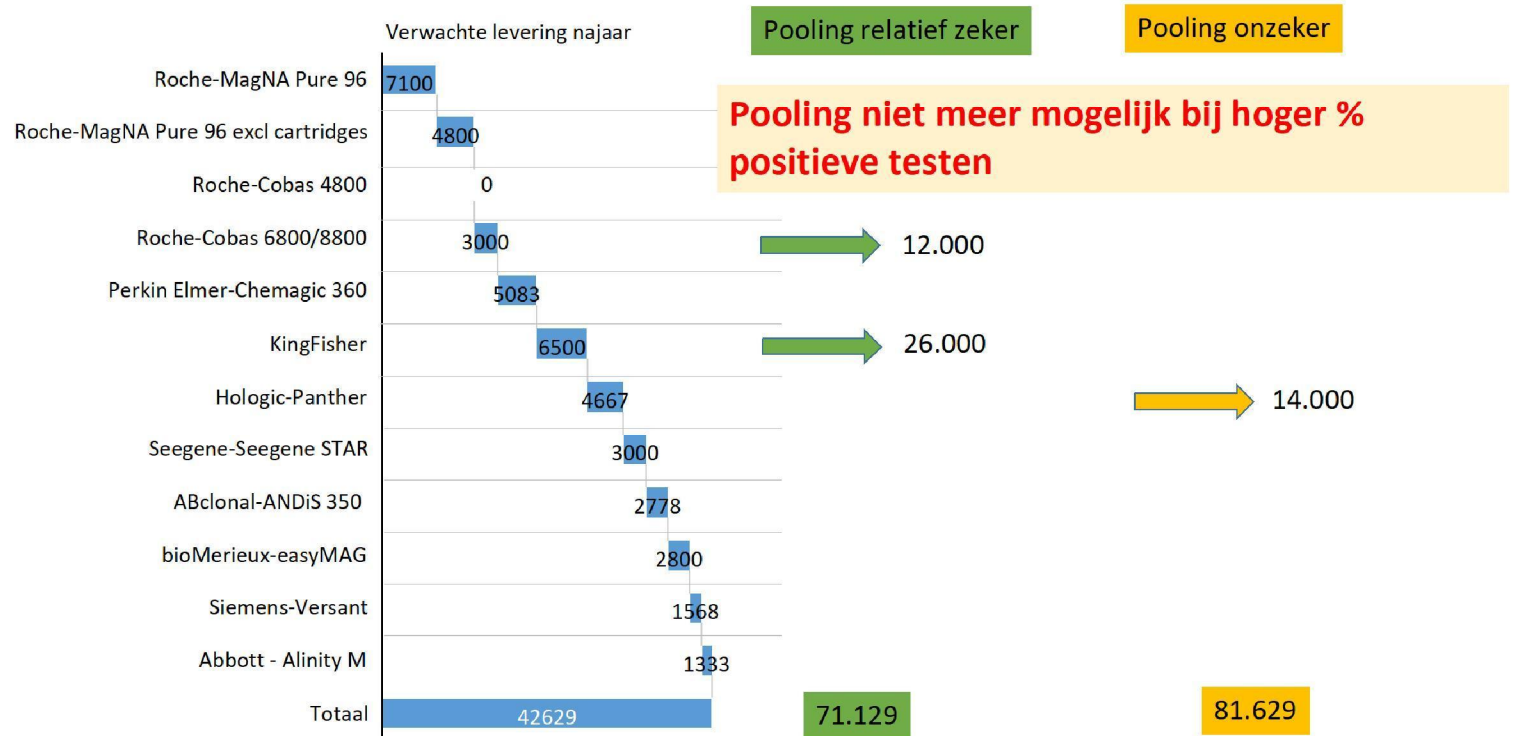



Aanbesteding nieuw wagenpark

Nu in zicht ^{(10)(2b)}/dag → benodigd ^{(10)(2b)}/dag enkelvoudige testen

Additioneel € ^{(10)(2b)}

Open House constructie:

- VWS selecteert geschikte aanbiedingen
- Laboratorium selecteert wat past bij behoefte (met enige sturing van LCDK)
- VWS sluit garantieovereenkomst af met leverancier
- Laboratorium sluit leverovereenkomst af met leverancier

Pas financieel risico VWS na
 sluiten
 garantieovereenkomst

Voorwaarden geschikte aanbidding o.a.:


- Apparatuur op lease-basis incl. testen, gedurende 6 maanden, met 6 maanden verlengingsoptie
- Geen apparatuur aanbieden die al aanwezig is maar nog niet voorzien is van gewenste aantal testen

Haalbaarheid:


Marktconsultatie afgerond LCH:


- 20 leveranciers gereageerd
- Alle leveranciers akkoord met constructie
- Grote aantallen: Seegene, Thermo, GC Biotech, Hamilton/Molg3n

Gevraagd besluit stuurgroep:
 Akkoord met doorzetten
 aanbesteding?




Voorraad opbouw RNA extractie + PCR reagentia

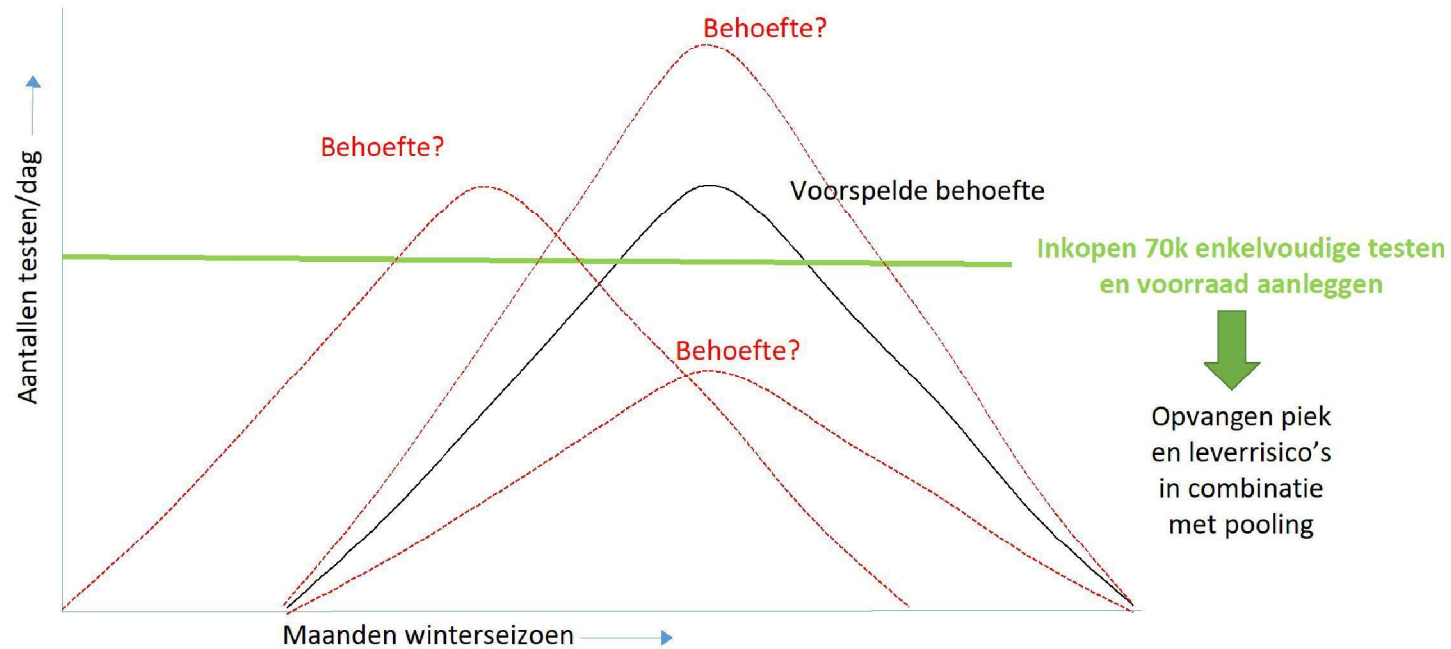



Vorraad opbouw RNA extractie + PCR reagentia

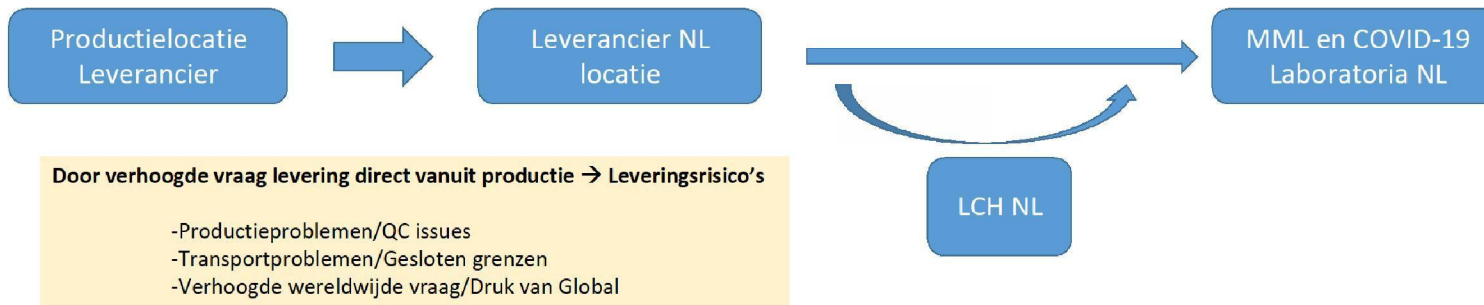

Advies leveranciers:

Deze zomer al voorraad innemen:
3 maanden maximale duurzame lab capaciteit voorraad


Prioritering plaatsing voorraad:

- 1) Laboratoria
- 2) LCH

Gevraagd besluit stuurgroep:

Financiële garantiestelling voorraad laboratoria verhogen van 1 maand naar 3 maanden.

Indien geen plek op laboratoria zal LCH voorraad innemen.



Verleggen stromen ivm voorraad opbouw (LCDK)

(10)(2e) licht toe:

Verzoek om stromen te verleggen voor laboratoria

-Microvida → COBAS6800 testen zijn straks met pooling mogelijk 4x zo veel waard
Voorraad nu verder opbouwen en niet verbruiken

(10)(2e) → Teert te veel in op voorraad Siemens