

To: opschalingslabs[5.1.2e]@rivm.nl
From: 5.1.2e
Sent: Fri 9/18/2020 10:35:16 AM
Subject: RE: Sensitiviteitspanel, specificiteitspanel en 15 klinische monsters
Received: Fri 9/18/2020 10:35:17 AM

Hoi 5.1.2e

Mooi

Bestandsnaam document performance moet zijn performance.

In de zin 'confirmation 5 positive and 10 negative samples with a correct result' het woordje 'of' tussenvoegen:
'confirmation of 5 positive and 10 negative samples with a correct result'

Ik heb voorkeur voor gebruik van specimens ipv samples als het op die zin past zonder dat de zin omslaat.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e

From: opschalingslabs <5.1.2e@rivm.nl>
Sent: vrijdag 18 september 2020 12:01
To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Subject: FW: Sensitiviteitspanel, specificiteitspanel en 15 klinische monsters

Akkoord met het document?

Groeten,

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@saltro.nl>
Verzonden: woensdag 16 september 2020 20:54
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@saltro.nl>
CC: 5.1.2e <5.1.2e@saltro.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@lab-partners.nl>
Onderwerp: RE: Sensitiviteitspanel, specificiteitspanel en 15 klinische monsters

Dag 5.1.2e

Wat mooi dat de resultaten er goed uit zien en dat jullie dit zo snel hebben kunnen oppakken.

De suggestie om een kleiner elutievolume te kiezen zullen we doorgeven. De PDF rapportages hebben we trouwens ook al in goede orde ontvangen, waarvoor dank.

De verklaring van prestatie kan inderdaad op naam worden gesteld van **Annab Laboratories LLC in Abu Dhabi** (behoort tot Unilabs UAE).

M.b.t. tot de twee andere vragen:

1. De CoronIT koppeling is direct met Unilabs Abu Dhabi, maar Saltro registreert alle CoronIT nummers die naar Unilabs Abu Dhabi worden gestuurd en ontvangt bijbehorende ruwe data van alle uitgevoerde bepalingen. Indien de GGD vragen heeft over uitslagen wordt er gecommuniceerd met de afdeling medische microbiologie van Saltro.
2. De rapportage van virologische dagstaat wordt door Saltro uitgevoerd. Wij ontvangen dagelijks van Unilabs Abu Dhabi rapportages met ruwe data om dit in goede orde te kunnen verwerken.

Hartelijke groeten,

5.1.2e

Arts-microbioloog

Van: 5.1.2i <5.1.2e@rivm.nl>
 Verzonden: dinsdag 15 september 2020 23:30
 Aan: 5.1.2e <5.1.2e@saltro.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@saltro.nl>
 CC: 5.1.2e <5.1.2e@saltro.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@lab-partners.nl>
 Onderwerp: RE: Sensitiviteitspanel, specificiteitspanel en 15 klinische monsters


Beste 5.1.2e

Bijgevoegd de resultaten van de confirmaties van de monsters die we ontvangen hebben en de verwachte resultaten van de panels die jullie ontvangen en getest hebben.

Confirmaties zijn identiek aan jullie resultaten. Dat is dus goed. Afzonderlijke formele uitslagformulieren volgen.


Bij beide workflows wordt het educational monster in het specificiteitspanel en het sensitiviteitspanel met 8.26 digitale kopiën SARS-CoV-2 RNA per ml gemist. Deze monsters worden door veel labs gedetecteerd, maar niet door alle. Deze monster hebben een viral load rond de LOD van veel workflows.

Proficiency panel SARS-CoV-2 bevattende monsters

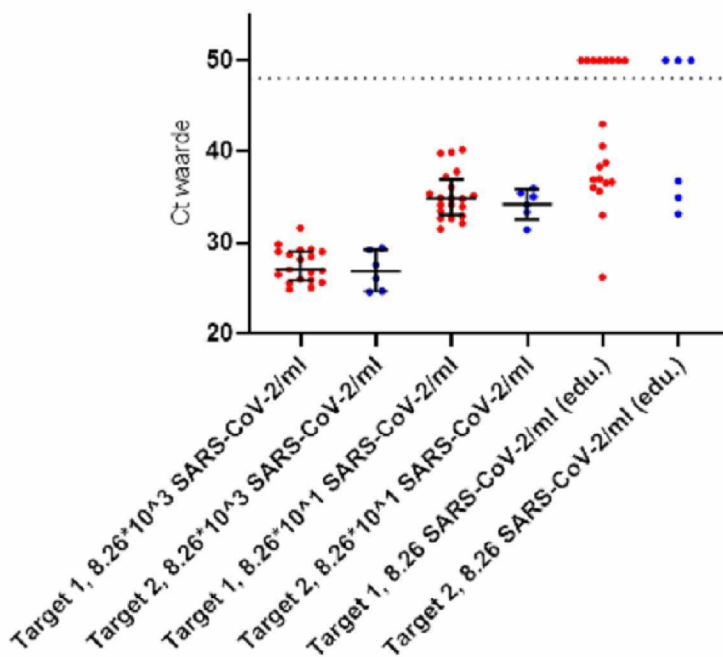

Concentratie op x-as is digitale kopiën RNA bepaald met RdRP dPCR.
 Niet alle laboratoria gebruiken test waar twee gen-targets worden gebruikt.
 Ct 50 = artificiele Ct waarde voor een negatief resultaat.
 Voor datasets zonder negatieve resultaten is mediaan met IQR weergegeven.

Sensitiviteitsserie SARS-CoV-2

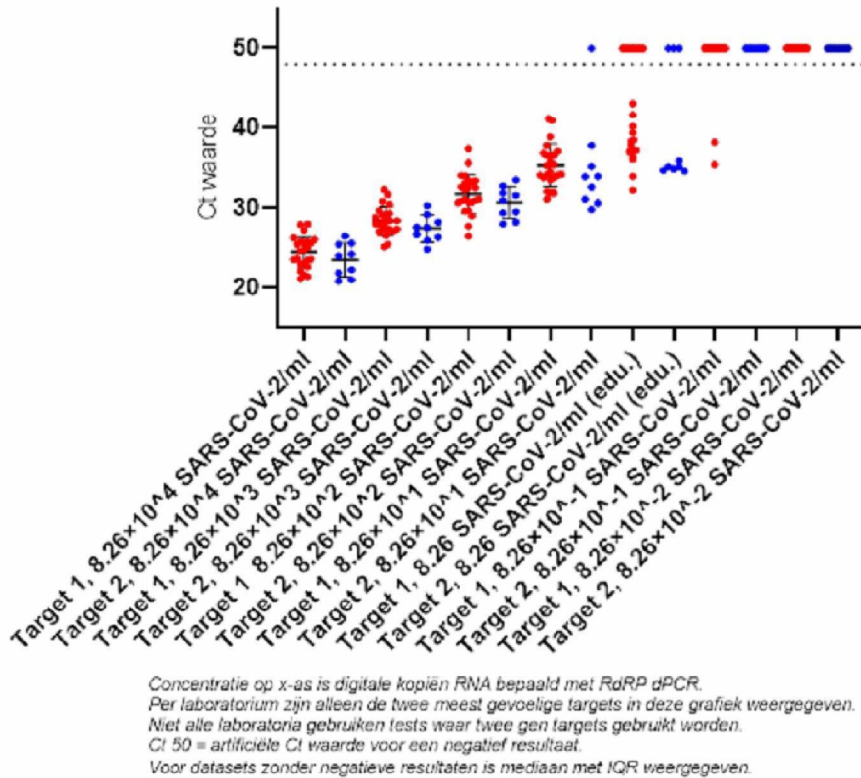

Mogelijk kan de gevoeligheid nog wat verhoogd worden door elutie in een lager volume dan 100 ul.

Om een verklaring van prestatie af te kunnen geven ontvang ik graag op welke labnaam in Abu Dhabi die gesteld moet worden. Of moet dat op naam van Saltro?

Nog een vraag. Jullie rapporteren resultaten van het lab daar in CoronIT of doet het lab daar dat. Dezelfde vraag over rapporteren in de virologische dagstaat. Graag hoor ik hoe die twee punten geregeld zijn.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@saltro.nl>

Sent: maandag 14 september 2020 09:10

To: opschalingslabs <5.1.2e@rivm.nl>

Cc: 5.1.2e <5.1.2e@saltro.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Subject: Sensitiviteitspanel, specificiteitspanel en 15 klinische monsters

Importance: High

Beste collega,

Met onze samenwerkingspartner in de Verenigde Arabische Emiraten willen we een tijdelijke uitbreiding van de testcapaciteit inrichten.

Uiteraard moet dit voldoen aan de hoogste kwalitatieve standaard. In de bijlage stuur ik de resultaten van het specificiteitspanel en sensitiviteitspanel.

Ik zie de uitslagen heel graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Arts-microbioloog

BIG: 5.1.2e

Saltro | Diagnostiek in de zorg

Mississippijreef 83 - 3565 CE Utrecht

Postbus 9300 - 3506 GH Utrecht

030 236 11 36

www.saltro.nl



Denk aan het milieu voordat u dit bericht
print.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
www.rivm.nl/en Committed to *health and sustainability*