


To: [5.1.2e] ([5.1.2e]@minvws.nl); [5.1 5.1.2e] ([5.1.2e]@minvws.nl); [5.1.2e]
([5.1.2e]) ([5.1.2e]@minvws.nl)
From: [5.1.2e] [5.1.2e]
Sent: Mon 9/28/2020 8:27:47 PM
Subject: RE: Conceptrapportage IGJ COVID-19 testen - samenvatting enrelevantie
Received: Mon 9/28/2020 8:27:48 PM

Beste [5.1.2e], Dank voor het document, en voor de synopsis ervan! Ik heb een onjuistheid gevonden: in de tabel van de innovatieve testmethode staat de lamp pcr aangegeven in de laatste colonne als minder specifiek en minder sensitief. Er is voorsnog niet iets wat daarop wijst dus ik denk dat daar moet staan dat dit nog onbekend is.

Verder viel mij op dat Spectrax in de rij innovatieve testen ontbreekt. Spectrax is een bedrijf met wie we in dialoog zij omdat ze als het goed is binnenkort klinisch gevalideerd gaan worden bij de GGD Amsterdam. Is het mogelijk om deze naam nog in de tabel te krijgen?

[5.1.2e]

[5.1.2e], [5.1.2e]
[5.1.2e] VWS

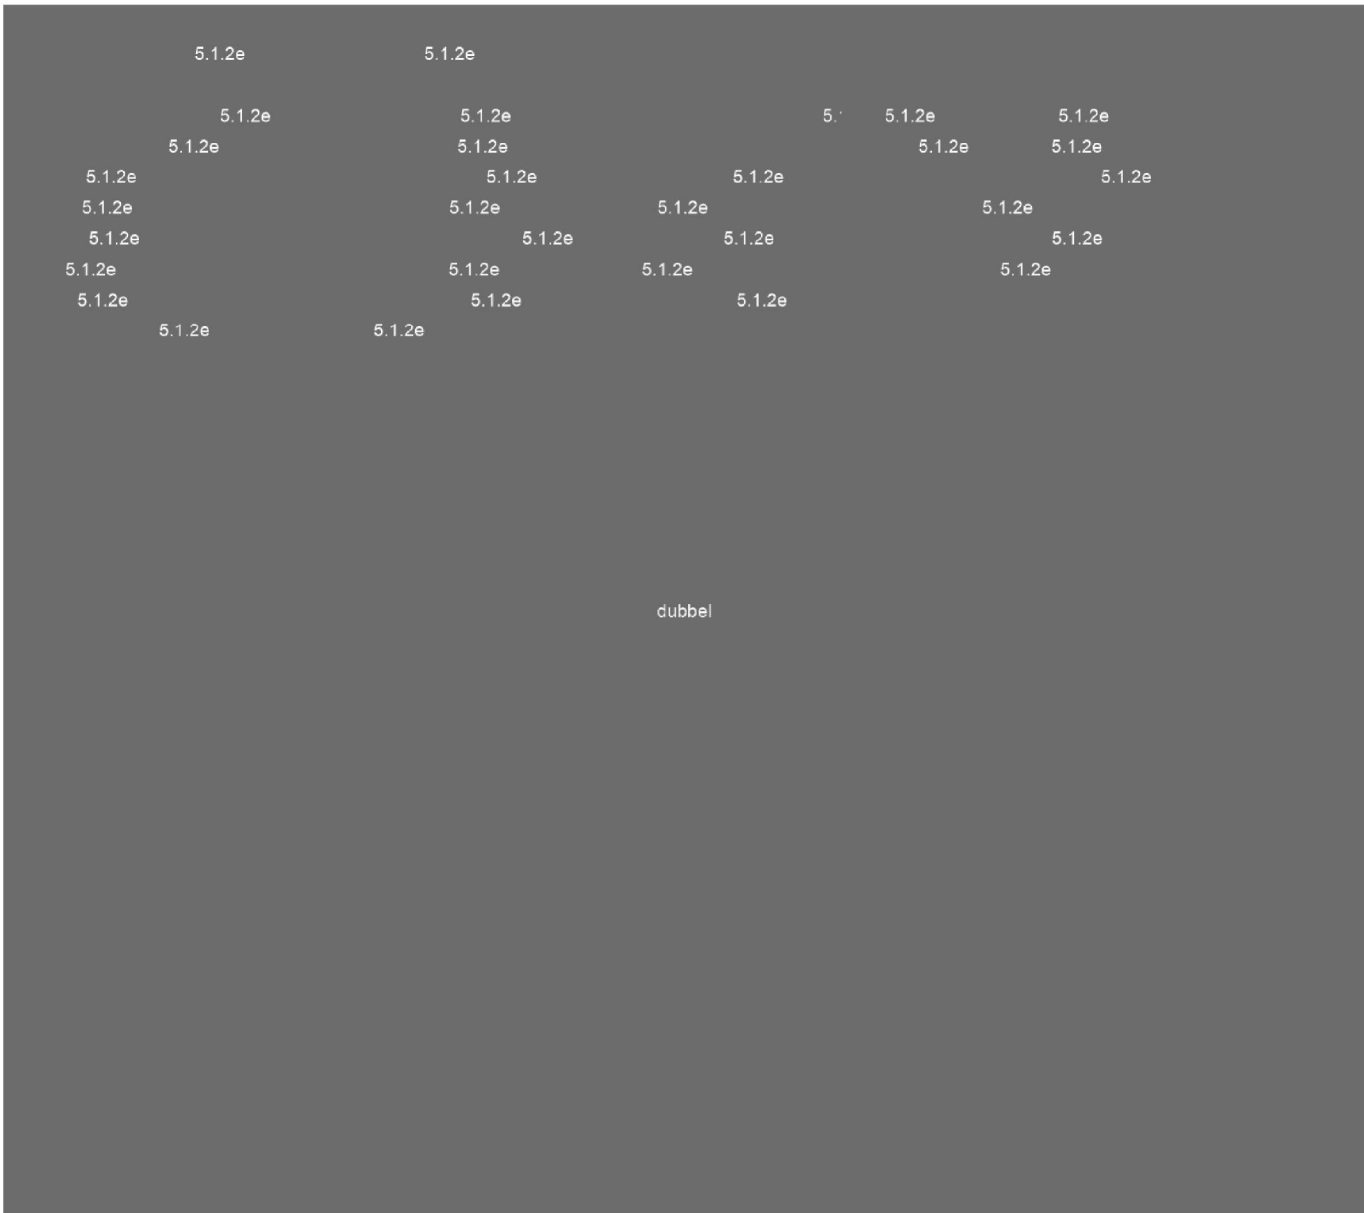

dubbel

2 - 3

dubbel