


To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @labmicta.nl]
 Cc: [redacted] 5.1.2e [redacted] @gmail.com [redacted] 5.1.2e [redacted] @gmail.com; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @labmicta.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] @labmicta.nl]
 From: [redacted] 5.1.2e
 Sent: Sat 8/22/2020 1:07:36 PM
 Subject: RE: resultaten speekselpanel
 Received: Sat 8/22/2020 1:07:37 PM
[Verwachte resultaten speeksel panel SARS-CoV-2 - ronde 1 versie 2.pdf](#)

Beste [redacted] 5.1.2e

Dank je wel voor de resultaten.


De vier monsters die door meeste labs worden gedetecteerd hebben jullie ook gevonden; en alle vier met alle drie de methoden van opwerking als zwakke curve meegerekend wordt. Het ene monster met laagste concentratie virus die jullie negatief scoren is een educational monster wat door weinig labs positief wordt gevonden. Bijgevoegd de verwachte resultaten en hieronder plaatjes van de resultaten van beste methode(s) per lab.

Speekselpanel SARS-CoV-2

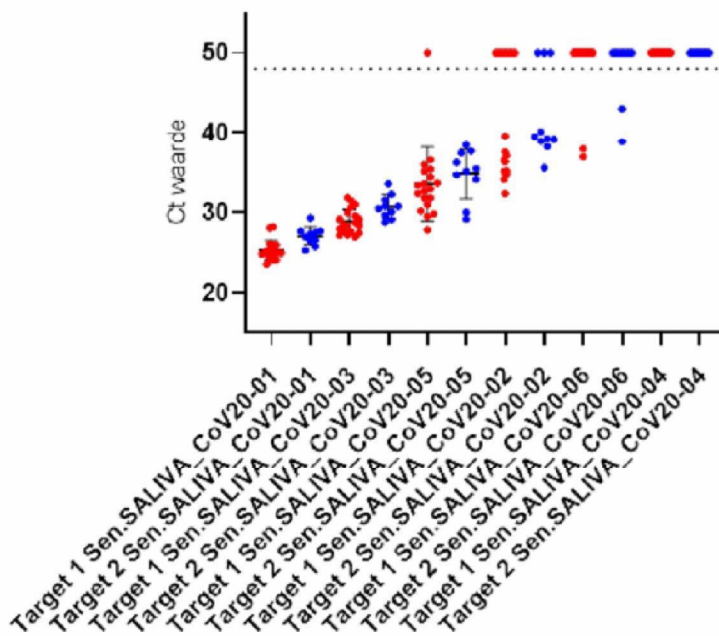

Per laboratorium zijn alleen de twee meest gevoelige targets in deze grafiek weergegeven.
 Niet alle laboratoria gebruiken tests waar twee gen targets gebruikt worden.
 Ct 50 = artificiële Ct waarde voor een negatief resultaat.
 Voor datasets zonder negatieve resultaten is mediaan met IQR weergegeven.

Kwalitatieve resultaten speekselpanel SARS-CoV-2

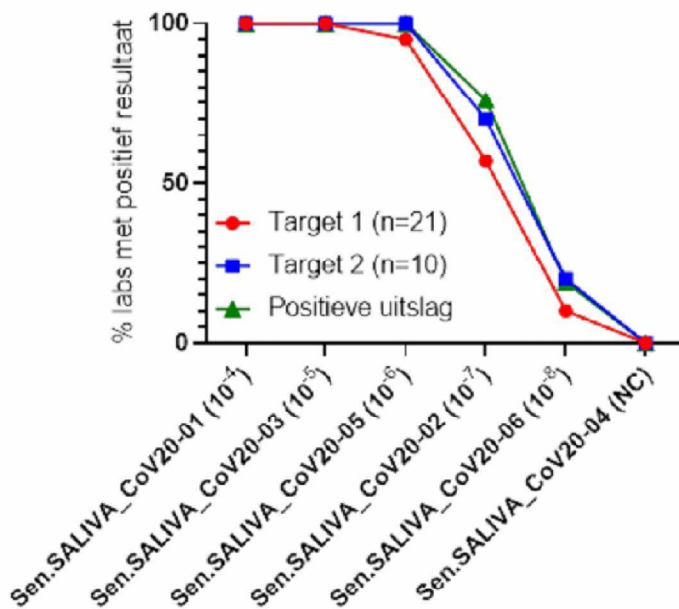

Per laboratorium zijn alleen de twee meest gevoelige targets in deze grafiek weergegeven. Niet alle laboratoria gebruiken tests waar twee gen targets gebruikt worden. Een positieve uitslag kan toegekend worden bij een dubbel positief (composiet) signaal van beide gen targets, of bij een positief signaal bij één van beide gen targets. In dit figuur staat het percentage positieve uitlagen per Sen.SALIVA serienummer weergegeven.

Jullie resultaten zijn voldoende goed in vergelijking met verwachte resultaten en rest labs om met speekselmonster aan de slag te gaan.

Zodra we met de GGDen in september van start gaan met speekselafname vragen we om 5 positieve en 10 negatieve speekselmonsters te sturen ter confirmatie.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@labmicta.nl>

Sent: donderdag 20 augustus 2020 11:41

To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Cc: 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>; 5.1.2e <5.1.2e@labmicta.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@labmicta.nl>

Subject: resultaten speekselpanel

Hallo 5.1.2e

Sorry voor de late reactie.

Hierbij de resultaten van het speeksel panel.

We hebben op 3 manieren een extractie uitgevoerd:

EMAG

Kingfisher Apex

DTT Opkoken

Alle resultaten heb ik in de tabel verwerkt.

Dit houdt wel in dat de extracties niet onmiddellijk na ontdooien zijn ingezet, ze zijn in de diagnostiek meegenomen in de volgorde KFA – DTT- EMAG. (na 1 tot 3 uur ongeveer)

Ik wacht je reactie af.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e