


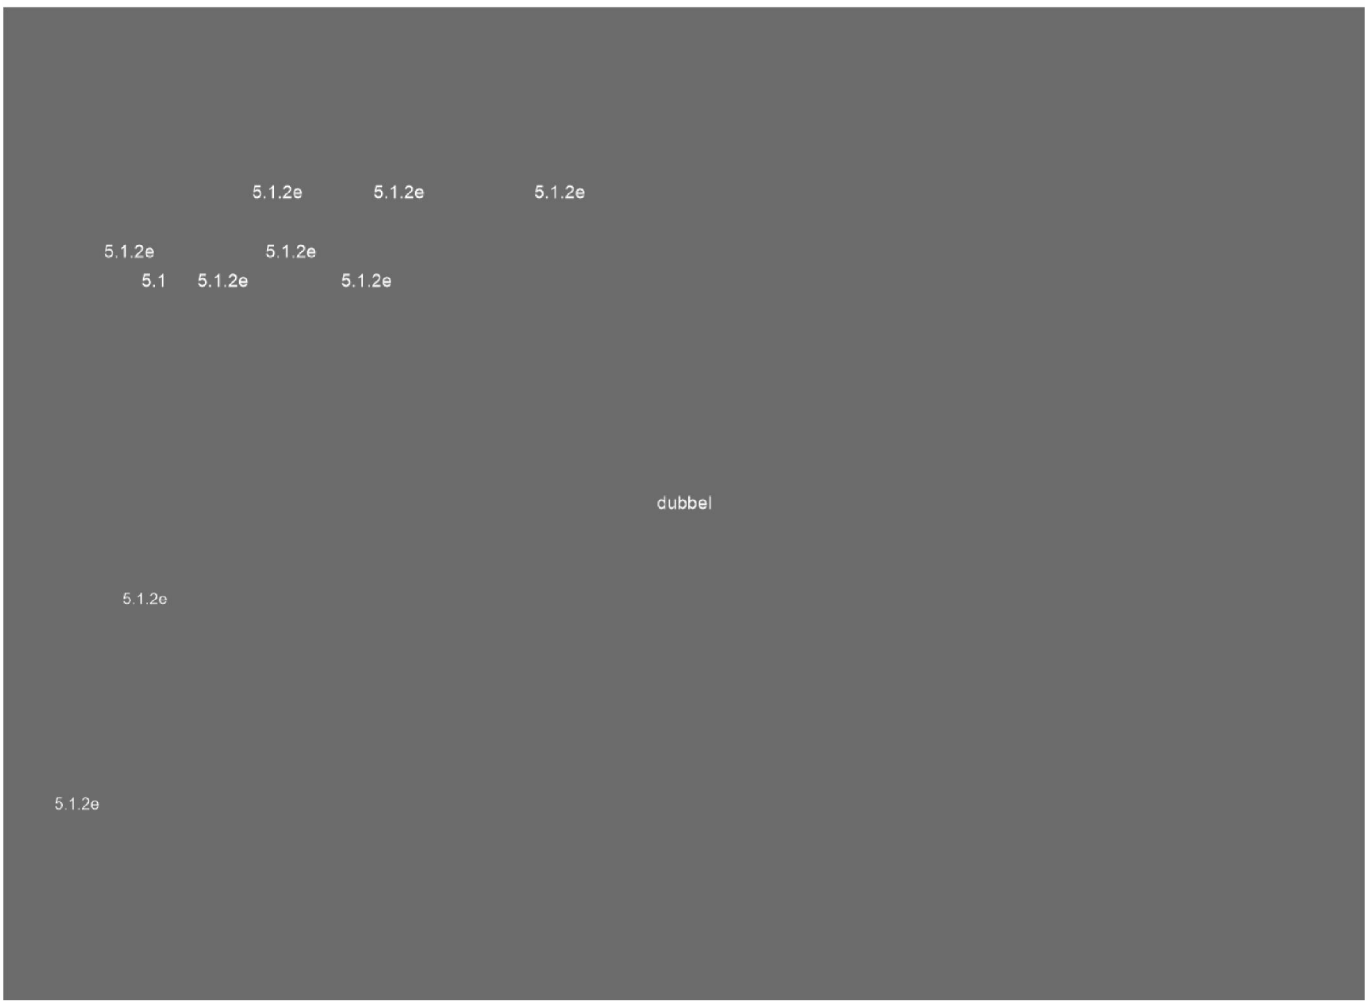
To: [redacted] ([redacted] 5.1.2e @minvws.nl)
Cc: [redacted] 5.1.2e ([redacted] 5.1.2e @minvws.nl); [redacted] 5.1.2e ([redacted] 5.1.2e @abbott.com]
From: [redacted] 5.1.2e
Sent: Thur 9/10/2020 11:19:41 AM
Subject: RE: Abbott Anti-SARS-CoV-2 serologische testen [vertrouwelijk]
Received: Thur 9/10/2020 11:20:06 AM

Geachte [redacted] 5.1.2e

Dank voor de reactie. Je bedoelt dan specifiek het OMT en dan de Taskforce Serologie ga ik van uit? Wij hebben ook nauw contact met meerdere microbiologen in het land die onze apparatuur ook op hun lab hebben staan. In meerdere perifere ziekenhuizen maar ook zeker op afdeling MMB van de diverse UMC's zoals LUMC, UMCG en ook UMCU is ivm een vervangingstraject naar onze apparatuur overstappen. Wij gaan de contacten hiervoor zeker oppakken.

Mvgr,
 [redacted] 5.1.2e

	[redacted] 5.1.2e	Abbott BV	O: [redacted] 5.1.2e
	[redacted] 5.1.2e	Wegalaan 9	M: [redacted] 5.1.2e
	Abbott Diagnostics	2132 JD Hoofddorp	[redacted] 5.1.2e @abbott.com
		The Netherlands	www.abbottnederland.nl



[redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e
 [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e
 [redacted] 5.1 [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e

dubbel

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

2 - 9

dubbel