


To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @rivm.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @rivm.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @rivm.nl
Cc: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @rivm.nl
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Tue 3/23/2021 5:55:12 PM
Subject: RE: goed vaccinbeheer_v3.1 *please review*
Received: Tue 3/23/2021 5:55:13 PM
[goed vaccinbeheer v3.1 5.1.2e docx](#)

Hoi collegae,

Bijgaand mijn commentaar.

Zoals al mondeling aan enkelen aangegeven heeft IGJ in overleg zojuist gezegd dat als je geen logger gebruikt, je anderszins moet kunnen aantonen dat de temperatuur binnen specificaties is geweest, dus ook voor transport. Er werd zelfs gesteld dat de andere producten in de dokterstas ook zo behandeld zouden moeten worden...

Groet, 5.1.2e

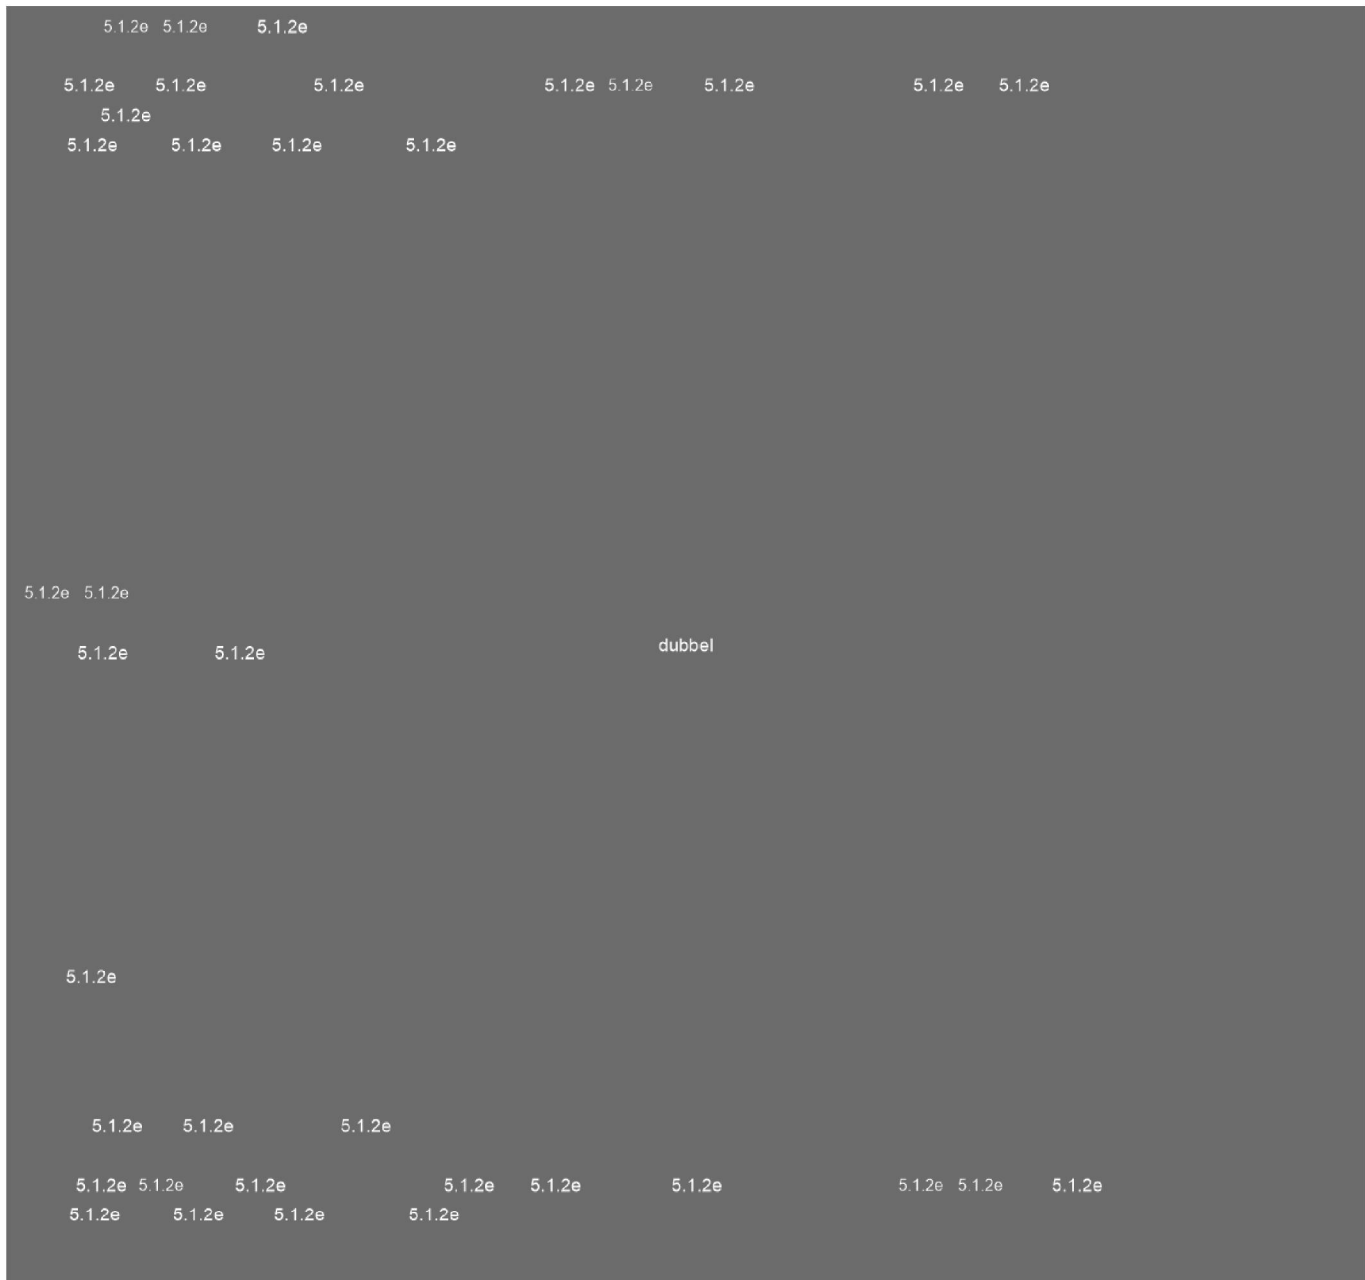

2 - 2

dubbel