

Stand van zaken LAMP-PCR


Over de test

De test meet:	Genetisch materiaal van het virus
Wijze van afname:	neus-keelwab door medisch geschoold personeel.
Verwerkingstijd:	1 uur
Analysesetting:	laboratoriumsetting, mobiel op locaties in te richten.

Beoogde uitrol:

Technische validatie:	afgerond
Klinische validatie:	in populatie die zich meldt bij GGD-teststraat, rapport is afgerond en wordt voorgelegd aan het OMT
Implementatiestudie:	afgerond. Uitrol in 5 grote teststraten wordt voorbereid.
Inkoop:	reagentia voor eerste uitrol zijn in bestelling.
Risico's:	beschikbaarheid van reagentia en materialen, beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd medisch en lab personeel voor afname en analyse.

Indicatieve tijdsplanning:

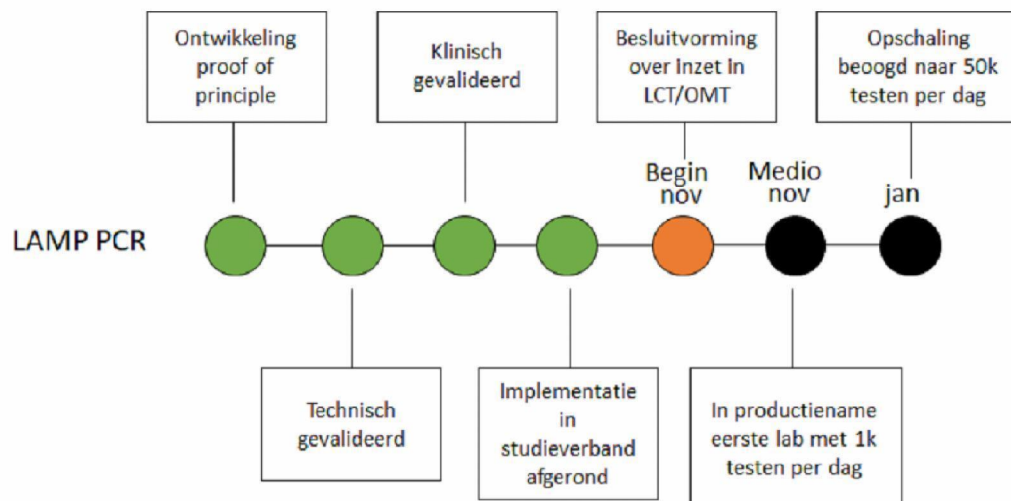

Stand van zaken Antigeentesten


Over de test

De test meet:	Virale eiwitten
Wijze van afname:	neus-keelwab door medisch geschoold personeel.
Verwerkingstijd:	15 minuten
Analysesetting:	door geschoold personeel in een flowkast of daarbuiten met gebruik van persoonlijke beschermingsmaterialen.

Beoogde uitrol:

Technische validatie:	afgerond
Klinische validatie:	Drie commerciële testen zijn gevalideerd in populatie die zich meldt bij GGD-teststraat. Studies in andere populaties worden voorbereid. Drie andere testen worden momenteel nog gevalideerd, en er is een openbare aanbesteding gedaan voor de validatie van testen van andere fabrikanten.
Implementatiestudie:	in afronding voor de gevalideerde commerciële testen. Uitrol in teststraten wordt voorbereid.
Inkoop:	4,7 mln. testen besteld die in november geleverd worden.
Risico's:	Beschikbaarheid van de tests, beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel voor afname en analyse.

Indicatieve tijdsplanning:

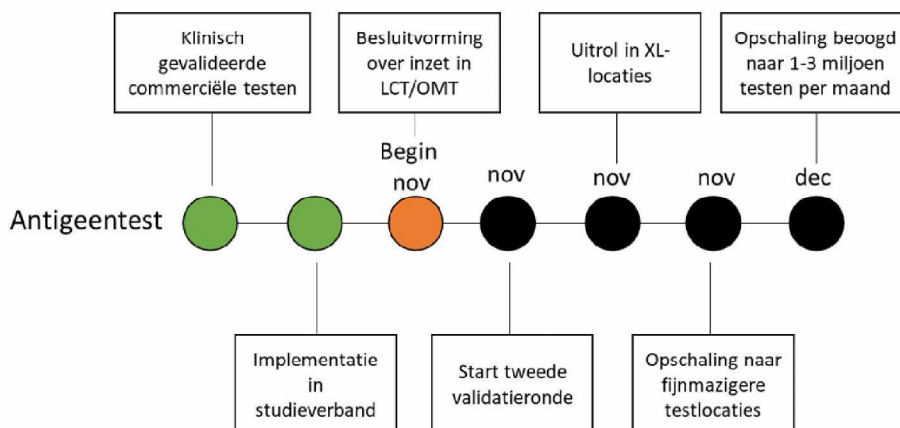

Stand van zaken Ademtesten

Over de test

De test meet:	Vluchtige organische componenten
Wijze van afname:	Blaastest
Verwerkingstijd:	5 minuten
Analysesetting:	door geschoold personeel met gebruik van persoonlijke beschermingsmaterialen.

Beoogde uitrol:

Technische validatie:	afgerond
Klinische validatie:	Eerste studie op één type ademtest is afgerond. Een vervolgstudie wordt voorbereid. Openbare aanbesteding voor andere aanbieders van ademtesten is in voorbereiding.
Implementatiestudie:	Eerste implementatiestudie is afgerond.
Inkoop:	500 apparaten besteld die gefaseerd geleverd worden
Risico's:	validatie nog niet volledig afgerond, beschikbaarheid van de apparaten, beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel.

Indicatieve tijdsplanning:

