


De totale testvraag neemt verder toe, gedreven door de GGD testafnames. Gemiddeld 52,2k testen per dag.

Verloop van het aantal testen gemiddeld per dag gedaan, sinds 1 juni (in '1000 samples)

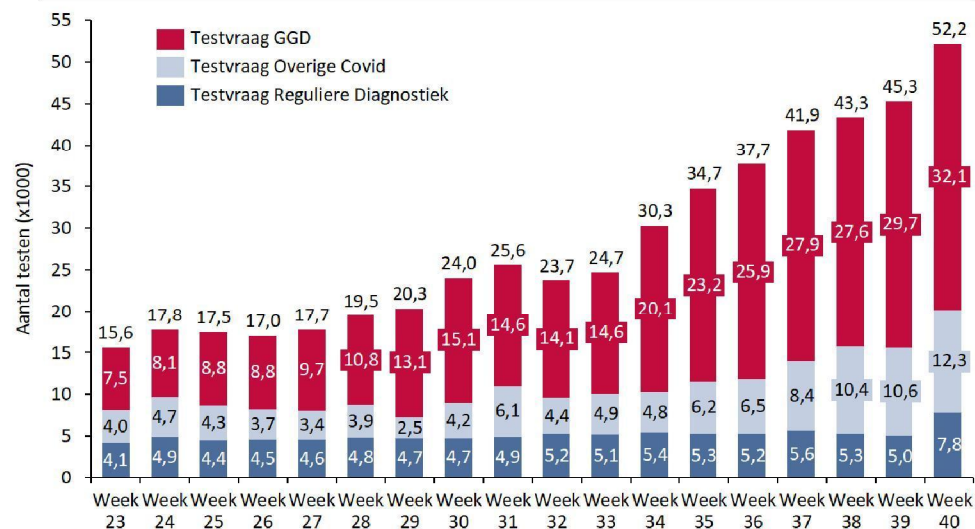

¹ Bronnen: CoronIT, 20200807 Testcapaciteit Labs Totaal_v week 40a


Opmerkingen

- Het aantal Covid testen neemt toe, gedreven door de toename uit de GGD teststraten.
- In de reguliere diagnostiek nemen we vanaf deze week een hoger cijfer meegenomen voor de HPV labs. Daarnaast is ook de bloedscreening van Sanquin meegenomen, deze is niet eerder zo gerapporteerd. Hierdoor is het totaal voor reguliere hoger dan voorheen. Dit heeft geen effect op de Covid testcapaciteit

De verwachte COVID (GGD + niet-GGD) en non-COVID testcapaciteit op basis van huidige schattingen is 111.000 netto per dag op 2 november

Opbouw van prognose testcapaciteit ('1000/dag)

Opmerkingen

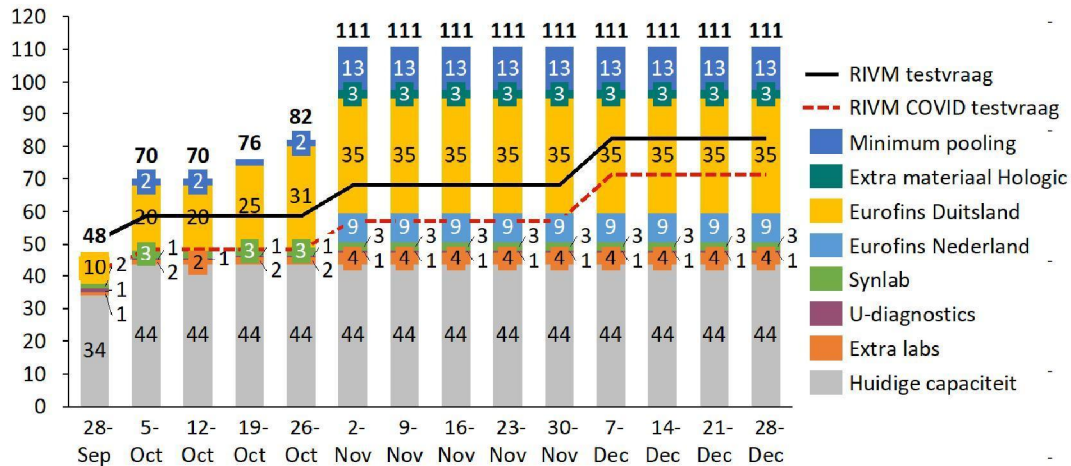

- Dit is zowel COVID als regulier medische testcapaciteit
- Dit gaat over **netto** testcapaciteit, namelijk het aantal samples dat getest kan worden voor zowel COVID als non-COVID. Aangenomen is dat commerciële labs ook zo hun beschikbaarheid opgeven.
- Gefaseerde pooling voor zowel pandemielabs als MML's tot een totaal van 13.000 tests per dag in December. In januari mogelijk meer pooling. Met de **huidige prevalentie** kan de **extra capaciteit** door pooling **tegenvallen of zelfs helemaal verdampen**.
- Eurofins stelt testcapaciteit beschikbaar in Duitsland met een totaal van **5.1.1c** tests per dag. Wij gaan uit van een gefaseerd aanbod. Eurofins Nederland stelt **5.1.1c** capaciteit beschikbaar.
- De aanbesteding van machines is nog niet meegenomen in dit overzicht omdat er nog **te veel onduidelijk** is over leveringstijden.
- Innovatieve testmethoden zijn niet meegenomen in dit overzicht. Tevens Synlab België nog niet.
- Dit is een **schatting** op basis van verschillende **aannames**

Change log - Week 28 dec is nieuw t.o.v. vorige week

Onderwerp	Van (datum)	Tot* (datum)	Van (aantal)	Naar (aantal)	Reden
Huidige capaciteit	5 okt	28 dec	34.051	43.503	Extra materialen Roche en Hologic, nieuwe machines bijgeplaatst bij o.a. Streeklab Haarlem en Star SHL
Extra materiaal Hologic	5 okt	2 nov	2.068	0	Meegenomen in huidige capaciteit
	2 nov	28 dec	5.110	3.042	2.068 meegenomen in huidige capaciteit
Extra materiaal Roche	5 okt	28 dec	1.825	0	Meegenomen in huidige capaciteit
U-Diagnostics	5 okt	28 dec	1.250	600	Kunnen voorlopig niet meer aan, geen zicht op wanner opschaling gerealiseerd kan worden
Synlab	5 okt	2 nov	1.500	2.500	Kan eerder opschalen
Extra labs	5 okt	28 dec	1.040, 2.590	1.540, 2.440, 2.000	Extra capaciteit bij labs. 500 tot 19 okt, 1.400 vanaf 19 okt

*Let op! "Tot" en niet "tot en met".


Data onderliggend aan plaatje slide 8

	28-sep	5-okt	12-okt	19-okt	26-okt	2-nov	9-nov	16-nov	23-nov	30-nov	7-dec	14-dec	21-dec	28-dec
RIVM testvraag	50774	58935	58935	58935	58935	68209	68209	68209	68209	68209	82516	82516	82516	82516
RIVM COVID testvraag	40974	48435	48435	48435	48435	57209	57209	57209	57209	57209	71516	71516	71516	71516
Minimum pooling	0	2000	2000	2000	2000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000
Extra materiaal Hologic	0	0	0	0	0	3042	3042	3042	3042	3042	3042	3042	3042	3042
Eurofins Duitsland	10000	20000	20000	25000	31000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000
Eurofins Nederland	0	0	0	0	0	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000
Synlab	1500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
U-diagnosics	1000	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Extra labs	1040	1540	1540	2440	2440	3990	3990	3990	3990	3990	3990	3990	3990	3990
Huidige capaciteit	34051	43503	43503	43503	43503	43503	43503	43503	43503	43503	43503	43503	43503	43504
Totale capaciteit	47591	70143	70143	76043	82043	110635	110635	110635	110635	110635	110635	110635	110635	110636



De GGD Covid capaciteit loop richting 2021 op naar 95.000

Opbouw van prognose testcapaciteit ('1000/dag)

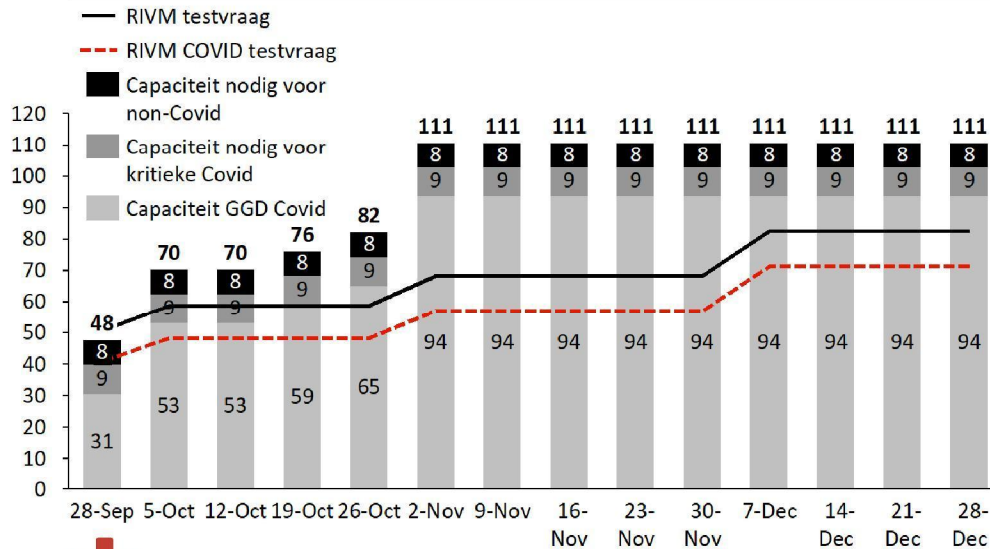

Opmerkingen

- Dit gaat over **netto** testcapaciteit, namelijk het aantal samples dat getest kan worden voor zowel COVID als non-COVID. Aangenomen is dat commerciële labs ook zo hun beschikbaarheid opgeven.
- De opbouw van deze testcapaciteit kan worden gezien in slide 8
- Zowel de **non-Covid** als de **kritieke Covid** worden aangenomen als **constant**.
- Dit is een **schatting** op basis van verschillende **aannames**

Capaciteit in oktober

<u>Oktober</u>	5-okt	12-okt	19-okt
Capaciteit netto total*	68.100	68.100	74.000
Capaciteit netto Covid*	60.400	60.400	66.300
Capaciteit netto GGD*	51.100	51.100	57.000

**Capaciteit zonder pooling vanwege huidige hoge prevalentie. Pooling staat wel in de slides hiervoor.*

