



Factsheet | Werkgroep testpaviljoens (LAMP & eNose)

Doel werkgroep	
Het bevorderen van de snelle en grootschalige uitrol van de LAMP en de ademtest in combinatie met de testpaviljoens.	
Samenstelling werkgroep	
■	Hoofdwerggroep
■	Subwerkgroep "2 ^{de} valideronde ademtesten"
■	Subwerkgroep "LAMP buiten testpaviljoens"
■	5.1.2e (RIVM)
■	5.1.2e (RIVM)
■	5.1.2e (eNose Company)
■	5.1.2e (GGD GHOR NL)
■	5.1.2e (GGD Amsterdam)
■	5.1.2e (LCH)
■	5.1.2e (TNO)
■	5.1.2e (RIVM)
■	5.1.2e (UMC Utrecht)
■	5.1.2e (GGD Amsterdam)
■	5.1.2e (VWS)
■	5.1.2e (LCH)
■	5.1.2e (TNO)
■	5.1.2e (GGD Rotterdam)
■	5.1.2e (WBVR)
■	Geert Groeneveld (LUMC)
■	5.1.2e (WBVR)
■	5.1.2e (Lankelma (GGD Amsterdam))
■	5.1.2e (LUMC)
■	5.1.2e (VWS)
■	5.1.2e (Universiteit Twente)
■	5.1.2e (VWS)
■	5.1.2e (UMC Utrecht)
■	5.1.2e (GGD GHOR NL)
■	5.1.2e (GGD Amsterdam)
■	5.1.2e (LCH)
■	5.1.2e (Amsterdam UMC)
■	5.1.2e (Amsterdam UMC)
■	5.1.2e (Amsterdam UMC)
■	5.1.2e (Breathomix)
■	5.1.2e (Erasmus MC)
■	5.1.2e (VWS)
■	5.1.2e (UMC Utrecht)
■	5.1.2e (Jeroen Bosch Ziekenhuis)
■	5.1.2e (RIVM)
■	5.1.2e (VWS)
■	5.1.2e (GGD Amsterdam)

LAMP-test (TNO)

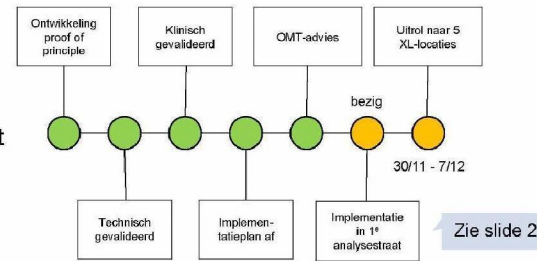

Ademtest (Breathomix)

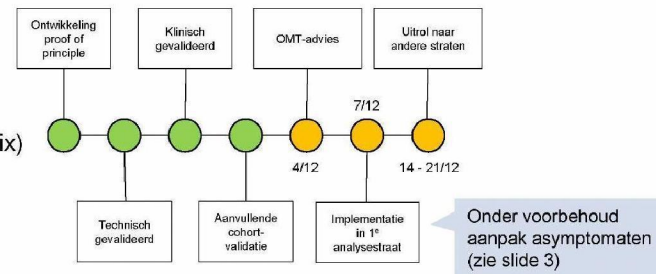

Factsheet | De eerste LAMP analysestraat wordt nu op de RAI geïmplementeerd; belangrijke stap is bepalen hoe het te gebruiken 'LAMP-pakket' er precies uit ziet



¹) Het pakket van verbruiksartikelen (*plasticware*, reagentia, buffers, etc.) en hardware (robots, PCR-machines, etc.) inclusief software dat nodig is om een LAMP-test te kunnen draaien.

²) De analyseopstelling voor LAMP is voorbereid op grootschalige verwerking van samples, o.a. door de inzet van robotisering. Deze robotisering zorgt dat het pakket aangepast dient te worden t.o.v. de validatie. Bijvoorbeeld omdat een buis die in de validatiesetting werd gebruikt niet goed aansluit op de specificaties van de robot die wordt gebruikt.

Factsheet | Subwerkgroep eNose concludeert dat inzet SpiroNose voor symptomaten verantwoord is, maar voor asymptomaten aanvullende validatie vraagt

Conclusies (sub)werkgroep validatie ademtesten

1 Voor symptomaten is het verantwoord om SpiroNose (Breathomix) in te zetten

2 Voor asymptomaten zijn aanvullende validatie-inzichten nodig van SpiroNose

3 Massaal testen in andere setting voor o.a. evenementen meenemen in OMT-advies

4 Aeonose (Enose Company) dient na afronding training en validatie in huidige setting, nog validatie in teststraat uitvoeren

Bespreekpunten: voorgestelde vervolgstappen

Uitwerken voorstel voor volgende stuurgroep om in teststraten die met SpiroNose gaan werken mensenstromen te scheiden¹

- Symptomen: inzet als pre-screening, gevolgd door PCR/LAMP bij testers indien besmetting niet uit te sluiten is
- Asymptomen: dubbele afname voor validatiestudie (SpiroNose + PCR/LAMP)

¹⁾ Indien inzichten niet uit reeds verzamelde data verkregen kunnen worden



Factsheet | Innovatieve sneltesten

Doel werkgroep

- criteria voor potentieel van nieuwe sneltests
- overzicht van innovatieve tests (niet uitputtend) en getoetst aan criteria
- validatiemethodiek om veelbelovende innovatieve tests op grote schaal in te kunnen zetten

Samenstelling werkgroep

- 5.1.2e (GGD A'dam)
- 5.1.2e (secretaris – VWS)
- 5.1.2e (GGD A'dam)
- 5.1.2e (GGD A'dam)
- 5.1.2e (VWS)
- 5.1.2e (VWS)
- 5.1.2e (GGD GHOR)
- 5.1.2e (LCDK)
- 5.1.2e (LCH)
- 5.1.2e (RIVM)
- 5.1.2e (UMCU)
- 5.1.2e (Erasmus MC)
- 5.1.2e (Amsterdam UMC)
- 5.1.2e (Amsterdam UMC)
- 5.1.2e (UMCU)
- 5.1.2e (Spektrax – lid validatiemethodiek)
- 5.1.2e (Spektrax – lid validatiemethodiek)
- 5.1.2e (LACDR – lid validatiemethodiek)

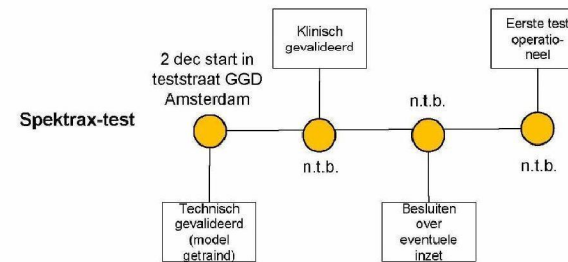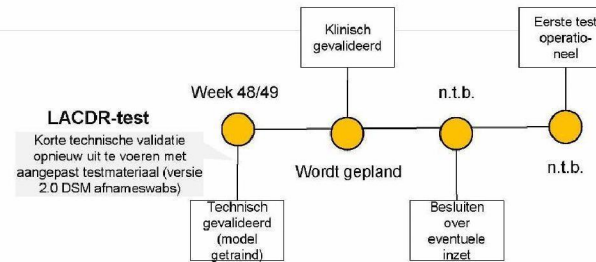

TIJDLIJN LATER TE BEPALEN

Factsheet | STRIP 25-11-2020

Doel werkgroep

- 100.000 PCR tests per dag met vijf robots
- pilot bij PAMM – STRIP-pilot en launch robot 1
- 4 extra robots – STRIP scale-up
- Operationeel vanaf april 2021
- Teststromen uit spoor 1 naar robots

Samenstelling werkgroep

Voorzitter: [5.1.2e] (adviesraad LSH)

Consortium STRIP i.o.: [5.1.2e] (Hubrecht),
[5.1.2e] & [5.1.2e] (Genmab), [5.1.2e]
[5.1.2e] (Sanquin), [5.1.2e] (PAMM),
[5.1.2e] (Bodegro)

OMT: [5.1.2e] [5.1.2e]
GGD/GHOR: [5.1.2e]
LCDK / Dienst Testen: [5.1.2e]
LCH: [5.1.2e], [5.1.2e]
Health Holland: [5.1.2e]
EZK: [5.1.2e]
VWS: [5.1.2e], [5.1.2e]

RIVM: [5.1.2e]

Secretaris: [5.1.2e]

