

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @archandhook.com]  
Cc: [redacted] 5.1.2e [redacted] [redacted] 5.1.2e [redacted] @minvws.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @archandhook.com]; [redacted] 5.1.2e  
From: [redacted] 5.1.2e [redacted] @archandhook.com]  
Sent: Thur 3/26/2020 3:38:43 PM  
Subject: RE: URGENT: Beademing systemen (1.000 stuks)  
Received: Thur 3/26/2020 3:38:43 PM


Hallo [redacted] 5.1.2e

De PA700B Medical V ventilatoren voldoen niet aan de eisen die onze expertgroep heeft opgesteld. Wij zijn daarom niet geïnteresseerd in deze 200 apparaten.

Als jullie ons echt kunnen garanderen dat de 1000 apparaten op 9 april geleverd worden, dan is dat een hele geruststelling.

Groet,

[redacted] 5.1.2e

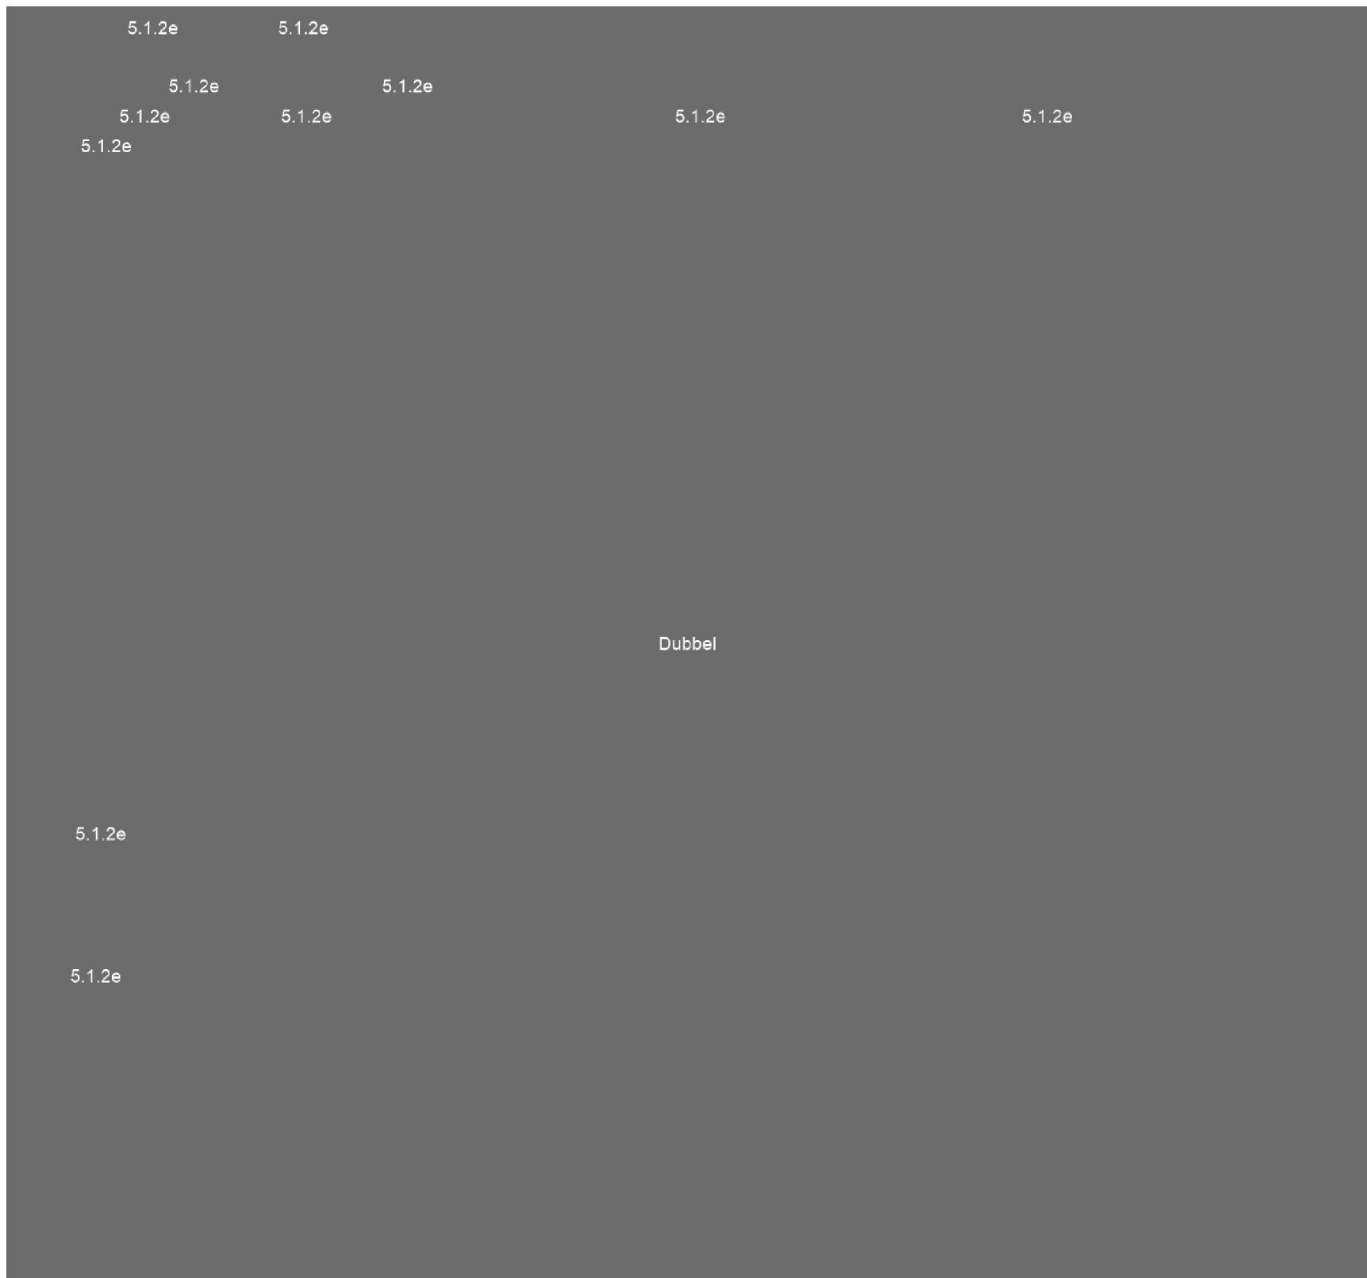

[redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e  
[redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e  
[redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e  
[redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e

Dubbel

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

2 - 5

Dubbel